測定結果一覧 測定項目 シアン化合物（令和7年度）

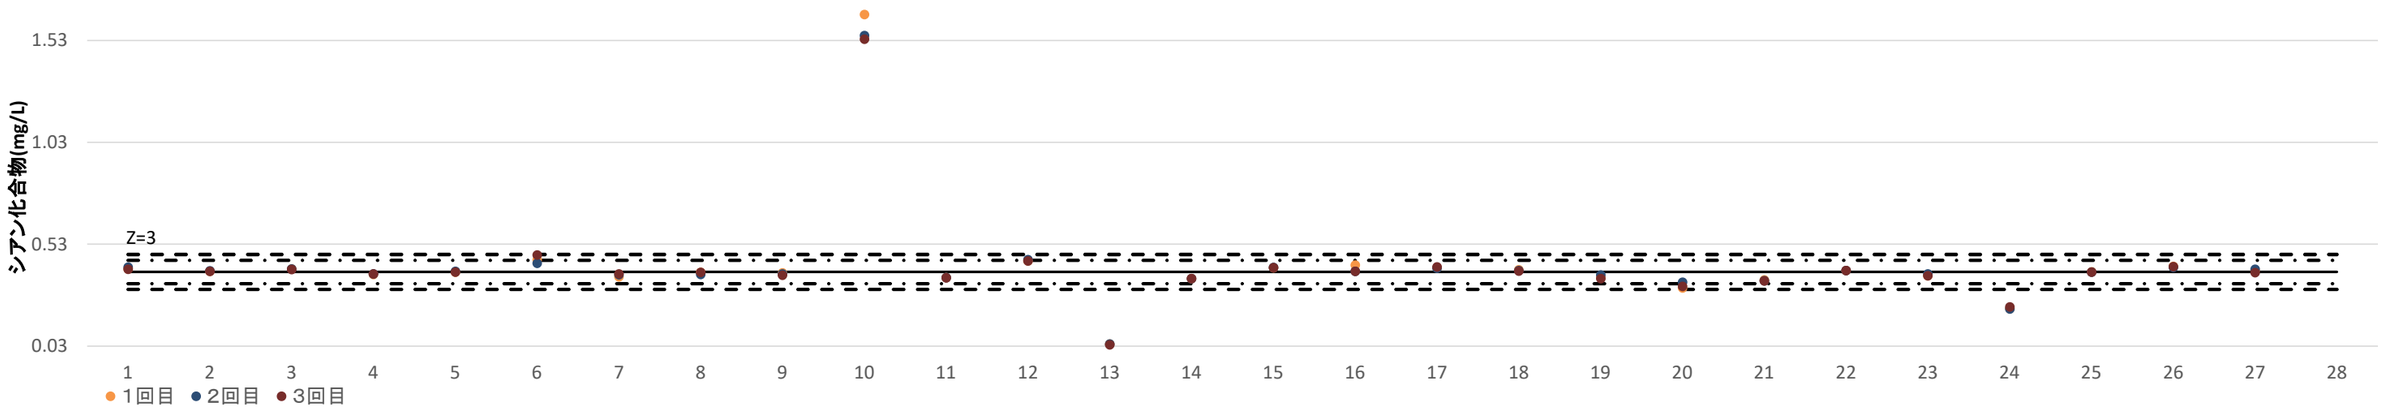

測定値 (mg/L)	1回目	0.408	0.397	0.409	0.382	0.393	0.453	0.371	0.392	0.389	1.657	0.367	0.448	0.041	0.362	0.415	0.428	0.415	0.405	0.367	0.315	0.355	0.401	0.376	0.214	0.394	0.421	0.401
	2回目	0.418	0.400	0.409	0.384	0.397	0.437	0.380	0.382	0.384	1.554	0.366	0.454	0.040	0.362	0.416	0.397	0.412	0.401	0.379	0.343	0.351	0.401	0.384	0.212	0.393	0.416	0.407
	3回目	0.407	0.397	0.406	0.384	0.393	0.478	0.384	0.392	0.378	1.536	0.365	0.448	0.037	0.361	0.415	0.397	0.419	0.399	0.361	0.323	0.350	0.401	0.376	0.223	0.393	0.420	0.391
平均値(mg/L)①		0.411	0.398	0.408	0.383	0.394	0.456	0.378	0.389	0.384	1.582	0.366	0.450	0.039	0.362	0.415	0.407	0.415	0.402	0.369	0.327	0.352	0.401	0.379	0.216	0.393	0.419	0.400
標準偏差②		0.006	0.002	0.002	0.001	0.002	0.021	0.007	0.006	0.006	0.065	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.018	0.004	0.003	0.009	0.014	0.003	0.000	0.005	0.006	0.001	0.003	0.008
CV(室内)(%)(②／①)		1.480	0.435	0.425	0.301	0.586	4.532	1.760	1.485	1.435	4.126	0.273	0.770	5.297	0.160	0.139	4.394	0.846	0.761	2.484	4.410	0.752	0.000	1.220	2.709	0.147	0.631	2.022
参加者平均との差		0.017	0.004	0.014	−0.011	0.000	0.062	−0.016	−0.005	−0.010	1.188	−0.028	0.056	−0.355	−0.032	0.021	0.013	0.021	0.008	−0.025	−0.067	−0.042	0.007	−0.015	−0.178	−0.001	0.025	0.006
Zスコア		0.592	0.137	0.487	−0.378	0.007	2.167	−0.553	−0.189	−0.364	41.598	−0.984	1.957	−12.421	−1.134	0.742	0.462	0.742	0.266	−0.879	−2.349	−1.474	0.242	−0.539	−6.225	−0.028	0.872	0.196
Grubss検定による棄却											○			○											○			

平均値	0.394
標準偏差	0.0286
CV(室内)%	1.61

Zスコア	事業所数 27
|Z|≦2	22
2＜|Z|＜3	2
3≦|Z|	3

測定結果一覧 測定項目 シアン化合物（令和7年度）（Grubssの検定により棄却されたデータを除いたもの）

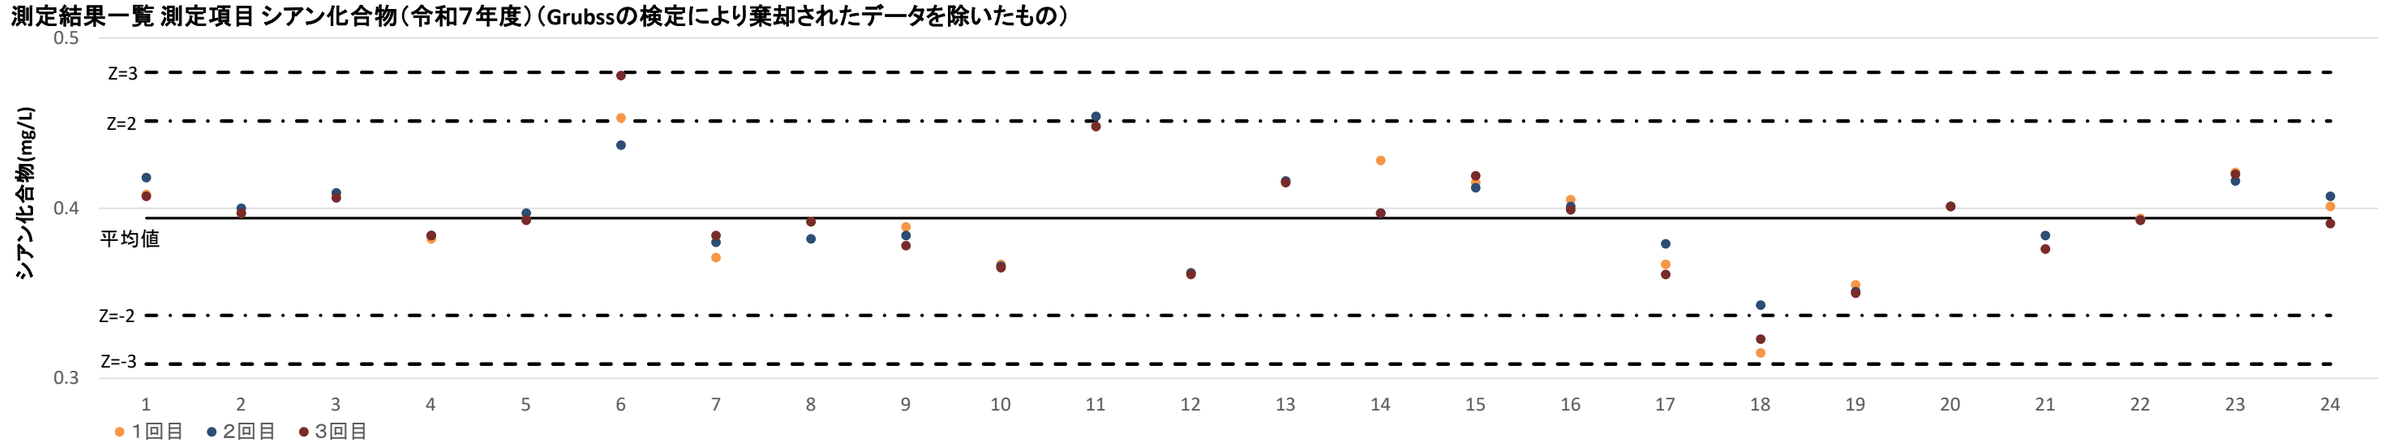

測定値 (mg/L)	1回目	0.408	0.397	0.409	0.382	0.393	0.453	0.371	0.392	0.389	0.367	0.448	0.362	0.415	0.428	0.415	0.405	0.367	0.315	0.355	0.401	0.376	0.394	0.421	0.401
	2回目	0.418	0.400	0.409	0.384	0.397	0.437	0.380	0.382	0.384	0.366	0.454	0.362	0.416	0.397	0.412	0.401	0.379	0.343	0.351	0.401	0.384	0.393	0.416	0.407
	3回目	0.407	0.397	0.406	0.384	0.393	0.478	0.384	0.392	0.378	0.365	0.448	0.361	0.415	0.397	0.419	0.399	0.361	0.323	0.350	0.401	0.376	0.393	0.420	0.391
平均値(mg/L)①		0.411	0.398	0.408	0.383	0.394	0.456	0.378	0.389	0.384	0.366	0.450	0.362	0.415	0.407	0.415	0.402	0.369	0.327	0.352	0.401	0.379	0.393	0.419	0.400
標準偏差②		0.006	0.002	0.002	0.001	0.002	0.021	0.007	0.006	0.006	0.001	0.003	0.001	0.001	0.018	0.004	0.003	0.009	0.014	0.003	0.000	0.005	0.001	0.003	0.008
CV(室内)(%)(②／①)		1.480	0.435	0.425	0.301	0.586	4.532	1.760	1.485	1.435	0.273	0.770	0.160	0.139	4.394	0.846	0.761	2.484	4.410	0.752	0.000	1.220	0.147	0.631	1.598
参加者平均との差		0.017	0.004	0.014	−0.011	0.000	0.062	−0.016	−0.005	−0.010	−0.028	0.056	−0.032	0.021	0.013	0.021	0.008	−0.025	−0.067	−0.042	0.007	−0.015	−0.001	0.025	0.006
Zスコア		0.592	0.137	0.487	−0.378	0.007	2.167	−0.553	−0.189	−0.364	−0.984	1.957	−1.134	0.742	0.462	0.742	0.266	−0.879	−2.349	−1.474	0.242	−0.539	−0.028	0.872	0.196
Grubss検定による棄却																									